Испытательные манометры типа трубки Бурдона
конструкция полностью из нержавеющей стали
класс 0,6%
DS 6" (150мм)

MN15

✔ - Все приборы поставляются с отчетом по калибровке сделанном по проверенному образцовому измерительному прибору.

CE Соответствует требованиям
PED 97/23/EC

Эти приборы были сконструированы для лабораторий, испытывающих приборы или выполняющих перекалибровку и другие работы, в которых в первую очередь важна точность и повторяемость. Они могут использоваться с жидкостями и газами, которые не имеют высокой вязкости и не кристаллизуются. Смачиваемые детали из нерж. ст. AISI 316L позволяют использовать их в сложных рабочих условиях с агрессивной окружающей средой или агрессивными средами технологического процесса. По требованию мы может предоставлять сертификат калибровки составленный международно признанной лабораторией ACCREDIA (Ex S.I.T. - Servizio Italiano Taratura - Итальянская сервисная служба по калибровке).

1.15.1 - Стандартная модель

Конструкция: EN837-1.
Обозначение безопасности: S1 согласно EN 837-2.
Класс точности: 0,6 согласно EN 837-1.
Температура окружающей среды: -13...+149 °F (-25...+65 °C).
Температура среды процесса: -40...+302°F (-40...+150 °C).
Температура калибровки: 68°F (+20 °C).
Тепловой дрейф: ±0,4 %/10 K от диапазона (начиная с 68°F - 20°C).
Рабочее давление: макс. 75% от значения для полной шкалы.
Предел избыточного давления: 30% от значения для полной шкалы.
Уровень защиты: IP 55 согласно IEC 529.
Материал патрубка: нерж. ст. AISI 316L .
Трубка Бурдона: бесшовная трубка из нерж. ст. AISI 316L.
Корпус: нержавеющая сталь.
Кольцо: нержавеющая сталь, байонетный зажим.
Окно: закаленное стекло.
Движущаяся деталь: нержавеющая сталь с внутренним стопором предела для минимального и максимального давления.
Шкала: алюминий, белая с черными делениями и антипаралаксной зеркальной полосой.
Стрелка: регулируемая, алюминий, черная, микрометр с острым краем.

Диапазон	Неосновная градуировка	Интервал для цифр	бар	кПа	МПа	psi
-1...0	0,005	0,10	✦			
0...0,6	0,002	0,05	✦		✦	
0...1	0,005	0,1	✦		✦	
0...1,6	0,005	0,1	✦		✦	
0...2,5	0,01	0,1	✦		✦	
0...4	0,02	0,2	✦		✦	
0...6	0,02	0,5	✦		✦	
0...10	0,05	1	✦		✦	✦
0...16	0,05	1	✦		✦	✦
0...25	0,1	1	✦		✦	
0...30	0,1	2	✦		✦	✦
0...40	0,2	2	✦		✦	
0...60	0,2	5	✦	✦	✦	✦
0...100	0,5	10	✦	✦		✦
0...160	0,5	10	✦	✦		✦
0...250	1	10	✦	✦		
0...300	1	20	✦	✦		✦
0...400	2	20	✦	✦		✦
0...600	2	50	✦	✦		✦
0...1000	5	100				✦
0...2000	10	100				✦
0...3000	10	200				✦
0...4000	20	200				✦
0...6000	20	500				✦

Испытательные манометры типа трубки Бурдона
конструкция полностью из нержавеющей стали, класс 0,6%, DS 6" (150мм)

MN15

RB3 - 08/11

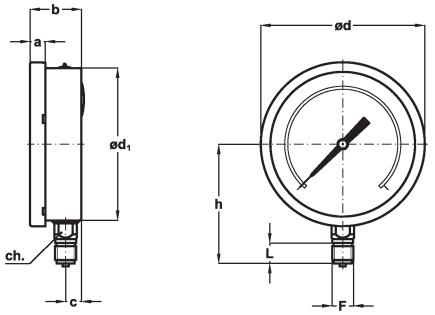

A - ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ

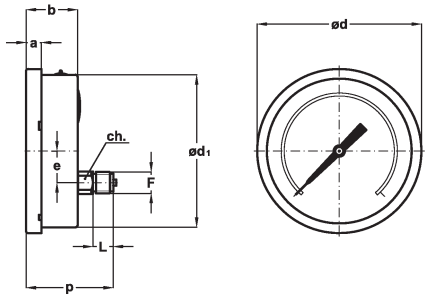

D - ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЗАДИ

Монтаж	F	a	b	c	ød	ød$_1$	e	h	p	ch	L	Вес
Нижний	**41M** - G 1/2 A **43M** - 1/2-14 NPT	0.59″ (15)	1.91″ (50,5)	1.98″ (15,5)	6.33″ (161)	5.88″ (149,6)		4.60″ (117)		0.86″ (22)	0.78″ (20)	2.07 фунт (0,94 кг)
Задний	**41M** - G 1/2 A **43M** - 1/2-14 NPT	0.59″ (15)	1.91″ (50,5)		6.33″ (161)	5.88″ (149,6)	1.22″ (31)		3.36″ (85,5)	0.86″ (22)	0.78″ (20)	2.07 фунт (0,94 кг)

Размеры : дюймы (мм)

ОПЦИИ

B -	"U"-образный зажим, для манометров с задним присоединением
C -	Задний фланец, для манометров с нижним присоединением
E -	Передний фланец, для манометров с задним присоединением
CE1 -	Сертификат ACCREDIA для манометров
CE3 -	Сертификат ACCREDIA для вакуума
T32 -	Окно из безопасного стекла

ДЕРЖАТЕЛЬ КОРПУСА МАНОМЕТРА

Приборы с радиальным присоединением могут поставляться с держателем корпуса манометра, код 5VAL.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел / Модель / Корпус / Монтаж / Диаметр / Диапазон / Присоединение к процессу / Опции

1	15	1	A	G		41M	B...E
			D			43M	CE1...T32

IN ORDER TO IMPROVE THEIR PRODUCTION, MESSRS. NUOVA FIMA RESERVE THE RIGHT TO THEMSELVES TO MAKE ALL THE MODIFICATIONS THAT THEY DEEM INDISPENSABLE AT ANY TIME. UPDATED DATA-SHEETS ARE AVAILABLE ON SITE: www.nuovafima.com

NUOVA FIMA S.p.A. - www.nuovafima.ru
P.O. BOX 58 - VIA C. BATTISTI 59 - 28045 INVORIO (NO) ITALY
TEL. +39 0322 253200 - FAX +39 0322 253232
телефон: +7 (495) 5438854 - факс: +7 (499) 6126929